



PNF P-03					
Entretien sanitaire quotidien, hebdomadaire, mensuel					
Créée par :	<u>Nathalie Tessier</u>	Date :	<u>Mars 2013</u>	Version:	<u>1.0</u>
Modifiée par :	<u>Marie-Ève Lebel</u>	Date :	<u>Novembre 2023</u>	Version:	<u>4.0</u>
Révisée par :	<u>Fany DeWilde et Nancy Thomas</u>	Date :	<u>Janvier 2024</u>		

<i>Chef de service et opérations</i>	 Nathalie Tessier	19-01-2024 Date
<i>Vétérinaire</i>	 Geneviève L. Roy	19-01-2024 Date
<i>Président du Comité de Protection des Animaux</i>	 Bruno Larrivée	19-01-2024 Date

1. BUT / OBJECTIF

Le but de cette Procédure Normalisée de Fonctionnement (PNF) est d'établir un horaire pour que l'entretien des pièces et de de l'Animalerie du Centre de Recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (ACRHMR) soit respecté et bien effectué.

2. APPLICABLE À / RESPONSABILITÉS

Cette PNF est la responsabilité de tout le personnel qualifié de l'ACRHMR qui procède à l'entretien sanitaire des pièces. Le personnel ayant à faire l'entretien dans une des pièces de l'animalerie doit lire, comprendre et appliquer cette PNF. Les membres du Comité de Protection des Animaux (CPA) doivent approuver et réviser cette PNF au moins aux 3 ans. La coordonnatrice de l'animalerie doit s'assurer que le personnel applique cette PNF correctement.

3. INFORMATIONS

Une liste des tâches hebdomadaires, quotidiennes et mensuelles est affichée dans chacune des pièces de l'animalerie (hébergement ou autre). Celle-ci doit être remplie à



chaque tâche effectuée. Ceci permet une standardisation de l'entretien à l'ACRHMR et donc un contrôle sanitaire efficace.

4. DÉFINITIONS

ACRHMR :	Animalerie du Centre de Recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
CPA :	Comité de Protection des Animaux
CRHMR :	Centre de Recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ESB :	Enceinte de Sécurité Biologique
PNF :	Procédure Normalisé de Fonctionnement
Utilisateur :	membre d'une équipe de recherche utilisant les services de l'animalerie

5. EXEMPLAIRES / FORMULAIRES / ATTACHEMENTS

Annexe I : Exemple d'une feuille d'entretien d'une pièce d'hébergement

Annexe II : Remplissage d'un vaporisateur d'isoflurane

Annexe III : Procédure de drainage manuel du lave-cage

6. MATÉRIEL / ÉQUIPEMENT

- Alcool (70%)
- Balais
- Débarbouillette
- Filtre de ventilation
- Isoflurane
- Liquide de Nettoyage / Lubrifiant pour rasoir
- Peroxigard (1:40)
- Porte poussière
- Produit de nettoyage pour acier inoxydable (ex. : 3M pour *stainless*)
- Quadricide PV15 (1 :256)
- Sacs pour linge souillé
- Sac de poubelle
- Serviette
- Vadrouille (Type Taski)
- Clé de remplissage Vapofil TM
- Vinaigre blanc



7. ÉTAPES / PROCÉDURES

Pour toutes les activités d'entretien, mettre ses initiales sur la fiche de suivi de l'entretien dans la case correspondante (voir annexe I) et suivre les procédures détaillées dans les PNF P-08 habillement et circulation à l'intérieur de l'animalerie et B-11 Laboratoire de niveau de confinement 2 – Animalerie.

7.1 Vestiaire pour les utilisateurs (GBSS420)

7.1.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Remplir le contenant de couvre chaussure à l'entrée de l'animalerie.
- Retirer le sac de la poubelle à l'entrée de l'animalerie et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Vérifier trois fois par jour les sacs de linge souillé (uniforme/serviettes) et les changer au besoin.
- Passer le balai.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Remplir le contenant de Peroxygard à l'entrée de l'animalerie (chariot métallique).
- Distribuer et placer les uniformes propres dans la salle GBSS420 et GBSS418B lors des livraisons (2 fois par semaine) ou au besoin.

7.1.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) le chariot à l'entrée de l'animalerie, les portes et poignées, les interrupteurs, l'armoire, le banc, ainsi que le support à balai.
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.1.3 Entretien mensuel

- Changer les filtres de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.

7.2 Salle d'entreposage de nourriture (GBSS422 et GBSS422A)

7.2.1 Entretien quotidien

- Vérifier que les pièges à vermine sont vides (GBSS422 et GBSS422A).
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien (il n'y a qu'un seul datalogger qui est placé dans la salle GBSS422A).

7.2.2 Entretien hebdomadaire

- Passer le balai.



- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, les portes et poignées et les interrupteurs.
- Faire du rangement.
- Vérifier les dates de péremption des sacs de nourriture et faire la rotation au besoin.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).

7.2.3 Entretien mensuel

Changer les filtres de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.

*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)

7.3 Entrepôt (GBSS419)

7.3.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.

7.3.2 Entretien hebdomadaire

- Passer le balai.
- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, les portes et poignées et les interrupteurs.
- Faire du rangement.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).

7.3.3 Entretien mensuel

Changer les filtres de ventilation au plafond (corridor et entrepôt) en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.

*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)

7.4 Salle de bureau (GBSS418), salle de bain (GBSS418A) et salle de vestiaire pour employés (GBSS418B)

7.4.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide (GBSS418B).

7.4.2 Entretien hebdomadaire

- Passer le balai.



- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, les portes et poignées, les interrupteurs, les tables, les chaises et les lavabos.
- Faire du rangement.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Le service de la salubrité effectue l'entretien du lavabo et de la toilette (GBSS418A) ainsi que du lavabo et de la douche (GBSS418B) (faire une requête au besoin).

7.4.3 Entretien au besoin

- Nettoyer les vitres avec du nettoyant à vitres.
- Nettoyer le four à micro-ondes.

7.4.4 Entretien mensuel

- Changer les filtres de ventilation au plafond (salle de bain et mini vestiaire) en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.

*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)

7.5 Côté propre (GBSS415 et GBSS415A)

7.5.1 Entretien quotidien

- Vérifier que les pièges à vermine sont vides (Salle 415 et GBSS042 (près de la hotte chimique)).
- Passer le balai et ensuite laver le plancher avec la moppe imbibée de PV15 (1 :256) dans la salle GBSS415A, GBSS415, GBSS427 (SAS à la salle GBSS428A), GBSS041 (corridor des salles d'hébergement) et le GBSS042 (corridor d'accès à l'animalerie).
- Changer le tapis bleu à l'entrée de l'animalerie.
- Retirer les sacs de poubelle dans la salle GBSS415 et du corridor GBSS042 (près de la hotte chimique) et en mettre des nouveaux.
- Retirer le sac de plastique blanc de serviettes souillées du corridor GBSS042 (à l'entrée du corridor menant aux pièces d'hébergement) et en mettre un neuf.

7.5.2 Entretien hebdomadaire

- Faire la préparation des aliquots d'acide qui seront utilisés pour la préparation des cruches d'eau et les entreposer sous la hotte chimique (voir la PNF P13).
- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 (1:256) les étagères, le lavabo, les portes et poignées, les interrupteurs, les bandes bleues.
- Nettoyer l'intérieur du stérilisateur à l'aide d'une débarbouillette imbibée d'eau et de vinaigre blanc (1:1).
- Effectuer un test d'étanchéité du stérilisateur (consulter la PNF P-05 pour plus de détails).

7.5.3 Entretien mensuel



- Nettoyer l'intérieur de la hotte chimique à l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40).
- Nettoyer tous les accessoires en acier inoxydable (porte du lave cage, porte du stérilisateur, porte d'armoire) à l'aide d'une débarbouillette sèche et du produit de nettoyage pour acier inoxydable (ex. : produit 3M pour *stainless*).
- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.

*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)

- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.6 Salle de chirurgie/manipulations de souris (GBSS410) et salle d'imagerie de souris (GBSS411)

7.6.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Vérifier le niveau d'oxygène et changer les bouteilles au besoin.
- Vérifier le niveau d'isoflurane et remplir au besoin selon la méthode décrite en annexe II.
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher avec le taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256)
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve

7.6.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 (1 :256) les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les portes et poignées, les interrupteurs, et poignées de frigo.
- Nettoyer l'extérieur de l'enceinte de sécurité biologique (ESB) à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 (1 : 256), le bouton de mise en marche et la manette de contrôle.
- Peser les filtres au charbon de la machine à anesthésie et changer au besoin.
- Nettoyer les rasoirs avec le liquide de nettoyage / lubrifiant pour rasoir.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.
- Changer l'eau osmosée pour l'entretien de l'appareil d'imagerie (GBSS411).
- Vider le congélateur des cadavres. Pour ce faire :
 - Prendre un chariot et mettre des gants
 - Prendre un sac de poubelle noir et y déposer environ 20 petits sacs de cadavres et bien fermer le sac.
 - Déposer les sacs de poubelle noirs sur le chariot et aller les porter dans le congélateur situé dans le corridor de la salle GBSS400.

7.6.3 Entretien mensuel



- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.

*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)

7.7 Salles d'hébergement de souris (GBSS217, GBSS423, GBSS407, GBSS408, GBSS409, GBSS425, GBSS426)

7.7.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide (**il y a 2 pièges dans la salle GBSS407).
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.

7.7.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1 :256) les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les portes et poignées
- Nettoyer l'extérieur de l'ESB à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 (1 : 256), le bouton de mise en marche et la manette de contrôle. Pour de plus beaux résultats, nettoyer la vitre de la hotte avec de l'alcool 70%
- Faire le nettoyage des drains en ouvrant le robinet et laisser couler 5 min. Tirer la chasse d'eau et fermer le robinet. Si le drain ne possède pas de robinet, utiliser un sceau rempli d'eau et le verser dans le drain.
- Retirer tous les filtres moteur des supports ventilés et les remplacer par des propres se trouvant dans la pièce.
- Nettoyer les filtres moteur retirés avec l'eau du robinet et laisser sécher.
- Faire le nettoyage partiel de l'ESB en retirant le plateau. À l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40) retirer l'excédent de litière accumulé au fond. Remettre le plateau.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.

7.7.3 Entretien mensuel

- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales ainsi que la date du changement sur le filtre.
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Effectuer le nettoyage complet de l'ESB:
 - Retirer le plateau.
 - À l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40), retirer l'excédent de litière accumulé au fond et les traces de sang.



- Il est possible qu'il y ait des filtres mousse, si c'est le cas, les nettoyer à l'aide d'un aspirateur (Shopvac) ou les changer au besoin.
- Pour les ESB de type ATS, changer les filtres.
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.8 Salle oxycycler (GBSS428A) et salle lumière bleue (GBSS428)

**Faire attention, s'il y a une affiche indiquant qu'il y a une expérience utilisant un laser ou de la lumière bleue en cours, mettre les lunettes de protection appropriées. S'assurer aussi qu'il n'y a pas d'affiche sur la porte GBSS428 qui empêche d'entrer dans la pièce. Veuillez consulter la PNF-08 pour plus de détails.

7.8.1 Entretien quotidien

- Vérifier que les pièges à vermine sont vides.
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien (il n'y a qu'un seul datalogger qui est placé dans la salle GBSS428A).
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Vérifier le niveau d'isoflurane et remplir au besoin selon la méthode décrite en annexe II.
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.

7.8.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les portes et poignées.
- Peser les filtres au charbon de la machine à anesthésie et changer au besoin.
- Retirer tous les filtres moteur des supports ventilés et les remplacer par des propres se trouvant dans la pièce.
- Nettoyer les filtres moteur retirés avec l'eau du robinet et laisser sécher.
- Faire le nettoyage partiel de l'ESB en retirant le plateau. À l'aide d'une débarbouillette imbibée Peroxygard (1 :40), retirer l'excédent de litière accumulé au fond. Remettre le plateau.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.

7.8.3 Entretien mensuel

- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales ainsi que la date du changement sur le filtre.
- *Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Effectuer le nettoyage complet de l'ESB :
 - Retirer le plateau.



- À l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40), retirer l'excédent de litière accumulé au fond et les traces de sang.
- Pour les ESB de type ATS, changer les filtres.
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.9 Salle de microchirurgie (GBSS 219)

7.9.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.

7.9.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1 :256) les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les portes et poignées.
- Passer le balai.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.

7.10 Salle d'hébergement des rats (GBSS 424)

7.10.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Passer le balai.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Retirer le sac de plastique blanc de serviettes souillées et en mettre un neuf.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.

7.10.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 (1 : 256) les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les portes et poignées.
- Faire le nettoyage des drains en ouvrant le robinet et laisser couler 5 min. Tirer la chasse d'eau et fermer le robinet. Si le drain ne possède pas de robinet, utiliser un sceau rempli d'eau et le verser dans le drain.
- Retirer tous les filtres moteur des supports ventilés et les remplacer par des propres se trouvant dans la pièce.
- Nettoyer les filtres moteur retirés avec l'eau du robinet et laisser sécher.



- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.

7.10.3 Entretien mensuel

- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.11 Salle des porcs (GBSS 401)

Note : n'appliquer la procédure qu'en présence d'animaux. S'il n'y a pas d'animaux, vérifier seulement le piège à vermine quotidiennement.

7.11.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Faire sortir les porcs de l'enclos et nettoyer les enclos avec du peroxygard et le boyau d'arrosage. Faire un rinçage des enclos.
- Faire une rotation des jouets dans les enclos avec des jouets propres.
- Rincer les jouets, les mettre dans un sac poubelles et envoyer du côté sale (GBSS413) pour un nettoyage profond.
- Nettoyer le plancher du corridor avec une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.

7.11.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 la tablette, le lavabo, les portes et poignées.
- Faire le nettoyage des drains en ouvrant le robinet et laisser couler 5 min. Tirer la chasse d'eau et fermer le robinet.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.

7.11.3 Entretien mensuel

- Changer les filtres de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.12 Chats-libre (GBSS 129)

7.12.1 Entretien quotidien



- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Vider les litières, les nettoyer et mettre de la litière propre.
- Changer la literie (draps, serviettes).
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.

7.12.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, le fonds des cages, les portes et poignées.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.

7.12.3 Entretien mensuel

- Changer les filtres de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.13 Chats condo (GBSS 221)

7.13.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Vider les litières, les nettoyer et mettre de la litière propre.
- Changer la literie (draps, serviettes) dans les condos.
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.

7.13.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, le fonds des cages, les portes et poignées, le lavabo.
- Changer le tapis collant bleu à l'entrée.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants et les contenants biohazard.



7.13.3 Entretien mensuel

- Faire du rangement dans l'armoire et la pièce.
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.

7.14 Salle d'hébergement des lapins (GBSS 128)

7.14.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxygard (1 :40).
- Changer les papiers des plateaux (aux 3 jours : lundi, mardi et vendredi)
- Mettre de la nourriture et remplir les bouteilles d'eau
- Changer les bouteilles/bouchons (2 fois par semaine : mardi et vendredi)
- Passer le balai.
- Retirer le sac de la poubelle de la salle et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce.

7.14.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée de PV15 (1:256) lavabo, comptoirs, porte et poignées.
- Remplacer le bac à aiguille et les contenants biohazard (au besoin)
- Changement de cage/jouet/abri
- Transférer la nourriture dans une mangeoire propre
- Préparation du peroxygard
- Changer le tapis bleu collant
- Nettoyage des enclos

7.14.3 Entretien mensuel

- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Faire du ménage des armoires/tiroirs
Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin

7.15 Salle d'hébergement de confinement 2 (NC2) (GBSS400)

7.15.1 Entretien quotidien



- Vérifier que les pièges à vermine sont vides (GBSS400, et corridor GBSS040).
- Prendre en note la température et le taux d'humidité de la pièce et l'inscrire sur la fiche de suivi de l'entretien.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%), de Peroxygard (1 :40) et de Virkon.
- Vérifier le niveau des bonbonnes d'oxygène et d'azote et les changer au besoin.
- Vérifier le niveau d'isoflurane et remplir au besoin selon la méthode décrite en annexe II.
- Passer le balai dans la salle GBSS400, le corridor (GBSS040) et le SAS (corridor GBSS040).
- Retirer le sac de la poubelle de la salle GBSS400, du corridor (GBSS040) et du SAS (corridor GBSS040) et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé de la GBSS400 et du corridor et en mettre des nouveaux.
- Nettoyer le plancher de la salle 400 et du corridor avec un taski et une serviette imbibée de Virkon (1 comprimé pour 500ml d'eau).
- Nettoyer le plancher du SAS avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Faire la liste de produits manquants de la pièce.

7.15.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40), les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les portes et poignées.
- Nettoyer l'extérieur de l'ESB à l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40), le bouton de mise en marche et la manette de contrôle. Nettoyer la vitre avec de l'alcool 70% pour un plus beau résultat.
- Faire le nettoyage des drains en ouvrant le robinet et laisser couler 5 min. Tirer la chasse d'eau et fermer le robinet.
- Peser les filtres au charbon de la machine à anesthésie et changer au besoin.
- Retirer les filtres du moteur du support ventilé et le remplacer par des propres se trouvant dans la pièce.
- Nettoyer les filtres moteur retirés avec l'eau du robinet et laisser sécher.
- Changer au besoin les contenants à objets tranchants.
- Faire le nettoyage partiel de l'ESB en retirant le plateau. À l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40) retirer l'excédent de litière accumulé au fond. Remettre le plateau.
- Nettoyer les rasoirs avec le liquide de nettoyage/lubrifiant à rasoir.

7.15.3 Entretien mensuel

- Changer le filtre de ventilation au plafond en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)
- Effectuer le nettoyage complet de l'ESB :
 - Retirer le plateau.
 - À l'aide d'une débarbouillette imbibée de Peroxygard (1 :40), retirer l'excédent de litière accumulé au fond et les traces de sang.
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.
- Disposer des cadavres d'animaux. Pour ce faire :



- Prendre une boîte Biohazard et y mettre deux sacs jaunes
- Mettre des gants
- Déposer les sacs de cadavres dans la boîte (maximum 25 lb)
- Fermer la boîte à l'aide de ruban adhésif (2")
- Apposer une étiquette de déchets anatomiques avec les informations de l'Hôpital.
- Sur la boîte cocher déchets anatomiques
- Aller porter la boîte dans la chambre froide de l'hôpital dans le corridor MASS516 le mercredi soir pour un ramassage le jeudi matin. Si le congélateur est barré, aller chercher la clé à la salubrité local MASS534

7.16 Côté sale (GBSS 413)

7.16.1 Entretien quotidien

- Vérifier que le piège à vermine est vide.
- Faire la préparation du Peroxigard (1:40).
- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les comptoirs et les lavabos.
- Vérifier qu'aucun matériel n'est tombé dans le plancher du lave-cage avant la mise en marche.
- Vider le drain du lave-cage.
- Retirer le sac de la poubelle, le mettre dans le conteneur à déchet et en mettre un neuf.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Enlever l'excédent d'eau en fin de journée à l'aide d'une râcle (Squeedgee).
- Nettoyer le plancher à l'aide du taski et d'une serviette imbibée de PV15 (1:256).
- Aller porter le conteneur à déchets pour ramassage par le service d'entretien.
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.
- A la fin de la journée, effectuer un drainage manuel du lave-cage
 - Appuyer sur START, Manuel Operations, Drain Sump (pour plus de détails consulter l'annexe III).

7.16.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1 :256) les portes et poignées, les interrupteurs et les bandes bleues.
- Nettoyer le filtre de l'ATS à l'aide d'un aspirateur (Shopvac).
- Vider les cages cytotoxiques dans une boîte de carton bio hasard (contenant un sac jaune) et en disposer à l'endroit prévu à cet effet (voir les PNFs B-04 et B-07).
- Nettoyer le socle à roulette de la poubelle avec du PV15 (1 :256).
- Vérification des buses du lave-cage pour s'assurer qu'elles ne soient pas bouchées.

7.16.3 Entretien mensuel

- Changer les filtres de ventilation au plafond (corridor) en prenant soin de mettre ses initiales, ainsi que la date du changement sur le filtre.
*Les filtres de ventilations seront changés aux 3 mois (janvier, avril, juillet et octobre)



- Changer le filtre de l'ESB de type ATS (Animal Transfer Station).
- Nettoyer tout le matériel en acier inoxydable à l'aide d'une débarbouillette sèche et du produit de nettoyage pour acier inoxydable (ex. : produit 3M pour *stainless*).
- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.
- Faire du rangement dans les armoires.

7.16.4 Entretien biannuel (aux 6 mois)

- Nettoyer le filtre dans la salle mécanique.

7.17 Salle de procédure terminale (Pavillon Claudine d'Amours)

7.17.1 Entretien hebdomadaire

- Aller chercher le matériel envoyé par le CRHMR au garage et le placer aux endroits appropriés.
- Remplir toutes les bouteilles d'alcool (70%) et de Peroxigard (1:40).
- Vérifier le niveau d'oxygène et changer les bouteilles au besoin.
- Vérifier le niveau d'isoflurane et remplir au besoin selon la méthode décrite dans l'annexe II.
- Peser les filtres au charbon de la machine à anesthésie et les changer au besoin.
- Nettoyer à l'aide d'une débarbouillette imbibée PV15 (1:256) les étagères, le lavabo, les chaises, les chariots, les interrupteurs, les portes et poignées
- Retirer les sacs de la poubelle et en mettre un neuf dans la pièce et dans le corridor.
- Retirer les sacs de linge souillé et en mettre des nouveaux.
- Passer le balai dans la pièce et dans le SAS.
- Retirer tous les filtres moteur des supports ventilés et les remplacer par des propres se trouvant dans la pièce.
- Nettoyer les filtres moteur retirés avec l'eau du robinet et laisser sécher.
- Nettoyer le plancher avec un taski et une serviette imbibée de PV15 (1:256) dans la pièce et dans le SAS.
- Faire la liste de produits manquants de la pièce pour remplir la réserve.
- Aller porter les sacs de poubelle, les sacs de linges souillés et les bouteilles d'oxygène vides au garage et les placer dans les bacs pour retour au CRHMR.

7.17.2 Entretien mensuel

- Faire la préparation de la solution de PV15 (1:256) au besoin.
- Disposer des cadavres d'animaux. Pour ce faire :
 - Prendre une boîte Biohazard et y mettre deux sacs jaunes
 - Mettre des gants
 - Déposer les sacs de cadavres dans la boîte (maximum 25 lb)
 - Fermer la boîte à l'aide de ruban adhésif (2")
 - Apposer une étiquette de déchets anatomiques avec les informations de l'Hôpital.
 - Sur la boîte cocher déchets anatomiques
 - Aller porter la boîte dans la chambre froide de l'hôpital dans le corridor MASS516 le mercredi soir pour un ramassage le jeudi matin. Si le congélateur est barré, aller chercher la clé à la salubrité local MASS534



8. RÉFÉRENCES / PROCÉDURES CONNEXES

- PNF B-04 : Préparation et désinfection des équipements avant lavage
- PNF B-07 : Mesures à prendre pour agents cytotoxiques
- PNF B-11 : Laboratoire de niveau de confinement 2 secteur animalerie
- PNF P-05 : Procédures laverie côté propre et utilisation du stérilisateur
- PNF P-08 : Habillement et circulation à l'intérieur de l'animalerie
- PNF P-13 : Procédures pour préparation de l'eau de boisson des animaux





ANNEXE I : Exemple d'une feuille d'entretien d'une pièce d'hébergement

Date	Quotidien										Hebdomadaire		Mensuel		
	Balai	Taski	Vider linge souillé (2 bacs) AM	Vider linge souillé (2 bacs) Midi	Vider linge souillé (2 bacs) PM	Placer uniformes *	Remplir les couvre-chaussures (à l'entrée animale)	Vider poubelle (à l'entrée animale)	Préparation Peroxygard (entrée de l'animale)	Vérification piège vermine	Chantot (à l'entrée de l'animale)	Préparation P.V.15%	Filter ventilation		
1															
2															
3															
4															
5															

ANNEXE II : Remplissage d'un vaporisateur d'isoflurane

TO FILL

1. Fermer le vaporisateur (valve B).
2. Tourner la vis (A) et insérer le Vapofil™ dans le vaporisateur. Serrer fermement la vis.
3. Soulever la bouteille d'isoflurane, puis ouvrir la valve (B)
4. Vérifier le niveau d'isoflurane. Lorsqu'il est plein, fermer la valve (B).
5. Baisser la bouteille d'isoflurane. Attendre. Tourner la vis (A) et retirer le Vapofil™

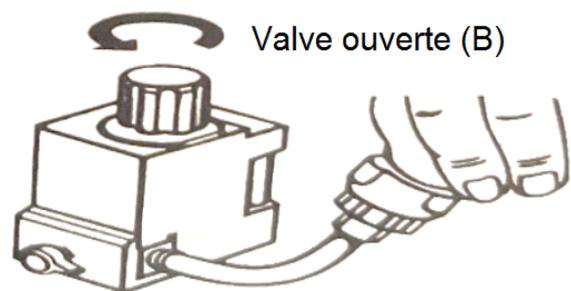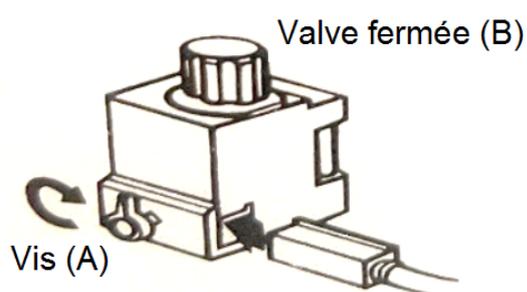




ANNEXE III : Procédure de drainage manuel du lave-cage

Procédure de drainage manuel du lave-cage de l'animalerie du CR-HMR (Getinge)

- À la fin de chaque journée, après le dernier cycle de lavage, il faut effectuer un drainage manuel du lave-cage.
- Voici la procédure à suivre sur l'écran du lave-cage (voir les photos en annexe) :
 - Appuyer sur START
 - Appuyer sur Manuel Operations
 - Appuyer sur Drain Sump qui passera de Off en rouge à ON en vert et ce pour la durée du drainage manuel. Lorsque le drainage est terminé, le Drain Sump redeviendra à Off en rouge
 - On peut maintenant fermer l'appareil en cliquant sur Main (bouton bleu en bas à droite et en tournant l'interrupteur à OFF

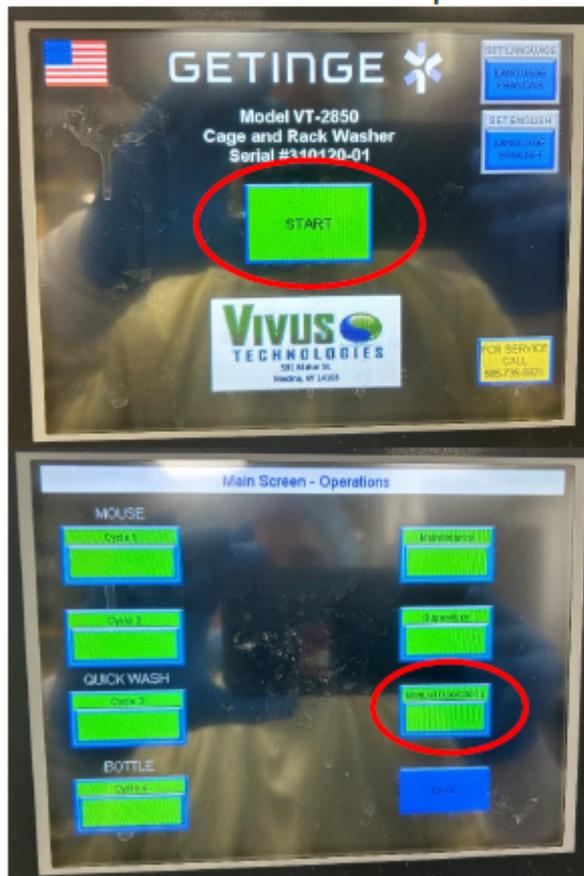



Rédigée par Jean-François Daudelin (infrastructure CR-HMR) le 17 novembre 2023

9. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Date	Modifications	Version
2021-11-01	Refonte de la PNF	3.0
2024-01-09	Mise à jour	4.0