


TOPO USI – 2020-06-12

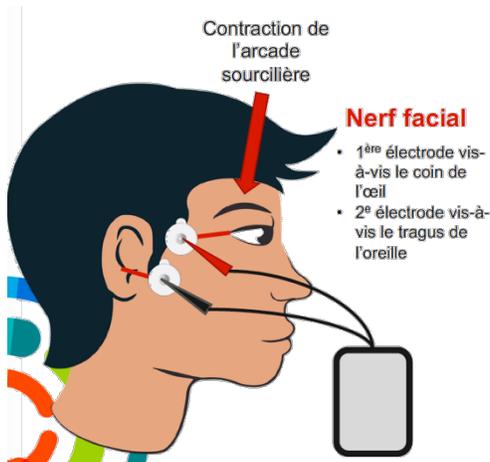

Nouveaux Neurostimulateurs

Nous avons fait l'acquisition de 4 nouveaux neurostimulateurs de la marque *SunMed*. Pour la sécurité d'utilisation, nous allons retirer celui que nous avions (le préhistorique qui n'était plus supporté par le GBM). Nous voulons que vous portiez une attention particulière à l'aide-mémoire mis en pièce jointe de ce courriel, puisqu'en révisant la technique de soins, nous n'avions pas la bonne position pour les électrodes stimulant le nerf facial : nous inversions les couleurs et nous ne les mettions pas à la bonne place. De plus, des précisions sur le niveau d'énergie à délivrer y sont inscrites.

Test à 30J des défibrillateurs sans les électrodes OneStep

Les défibrillateurs *R series* de *Zoll* peuvent effectuer un test à 30 joules lorsque le câble des électrodes est branché sur des électrodes de marque *OneStep*. Malheureusement, ces électrodes vivent quelques fois des «back order». Les électrodes de remplacement, les *StatPadz* ne permettent pas au défibrillateur d'effectuer un test à 30 joules lorsque le câble est branché à celles-ci. Une pièce jointe expliquant la manière de s'y prendre sans les électrodes est ajouté à ce courriel. En bref, il faut brancher le câble dans un port situé sur le côté droit du défibrillateur lui-même.



Étude clinique CONCOR-1 (plasma convalescent de la COVID-19)

Veillez lire la note de service mise en pièce jointe de ce courriel. Lorsque vous aurez des plasmas à administrer à un patient selon ce protocole de recherche, une OIP sera prescrite. La fréquence des signes vitaux est bien indiquée et la médication de secours aussi.

Dons de tissus urgents

Identifier le donneur potentiel

Vérifier si le défunt présente un des critères d'exclusion suivants :

- Âgé de plus de 85 ans
- VIH-VHB-VHC
- Infection systémique active et non traitée
- Cancer sanguin (lymphome, leucémie, maladie de Hodgkin)
- Alzheimer, Parkinson, démence d'étiologie inconnue

Lorsqu'un patient décède et qu'il est âgé de 85 ans et moins, vous devez **obligatoirement** vérifier son admissibilité au don de tissus selon les critères d'exclusion. S'il est admissible, vous devez communiquer avec Héma-Québec avant d'en discuter avec la famille. Ceux-ci vérifieront si le patient avait signé le registre. Si vous avez la carte d'assurance-maladie du patient, vous pouvez regarder s'il avait signé l'endos de celle-ci. Par la suite, Héma-Québec vous aidera dans vos démarches pour en discuter avec la famille. Éthiquement, vous ne pouvez pas prendre la décision pour la famille en décidant de ne pas leur offrir cette option.

Double vérification indépendante des prescriptions à l'admission

Voici une diapositive du cours sur l'admission que nous offrons à l'orientation. Les prescriptions ne doivent pas être vérifiées à 2 de manière simultanée. Nous avons souvent vu passer des rapports d'accident d'ordonnance non relevées parce que cette méthode avait été utilisée. C'est pour la sécurité de tous.

Les rôles infirmiers lors d'une admission

«Infirmière au dossier»

- Insère les feuilles dans le dossier (si agent administratif absent)
- Procède **SEULE** à la 1^{ère} vérification du dossier:
- Relève les prescriptions
- Fait prescrire le bilan comparatif des médicaments au transfert et l'OIP d'admission
- Révise la FADM
- Assure le suivi de toutes les ordonnances à l'infirmière au patient

«Infirmière au patient»

- Installe le patient (voir diapos «arrivée du patient»)
- Une fois le patient installé, procède **SEULE** à la 2^e vérification:
- Des prescriptions
- De la révision de la FADM

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'île-de-Montréal
Québec

Changement dans la nomenclature des liquides épaissis.

Veillez-vous référer à la note de service jointe à ce courriel. Elle vous donnera les informations sur la nouvelle nomenclature utilisée pour les liquides épaissis. Les termes «miel» et «nectar» ne seront plus au vocabulaire.

Sur ce, nous vous souhaitons une fin de semaine ensoleillée!

Marjo, Julie et Mylène