



Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical

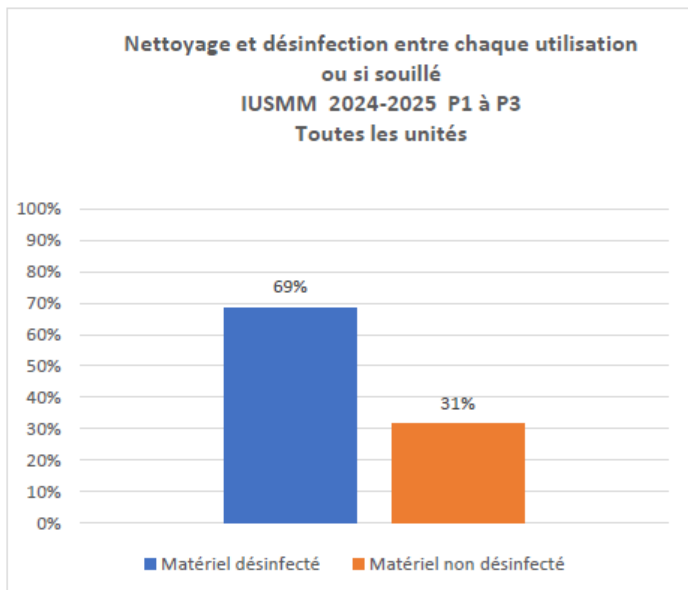


Le nombre total d'observations est de : 86
Le nombre d'observations conformes est de : 59
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 27




Le nombre total d'observations est de : 59
Le nombre total d'observations conformes est de : 48
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 11

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical




Le nombre total d'observations est de : 1
Le nombre d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 1




Le nombre total d'observations est de : 0
Le nombre total d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical




Le nombre total d'observations est de : 4
Le nombre d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 4




Le nombre total d'observations est de : 0
Le nombre total d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical




Le nombre total d'observations est de: 48
Le nombre d'observations conformes est de : 39
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 9

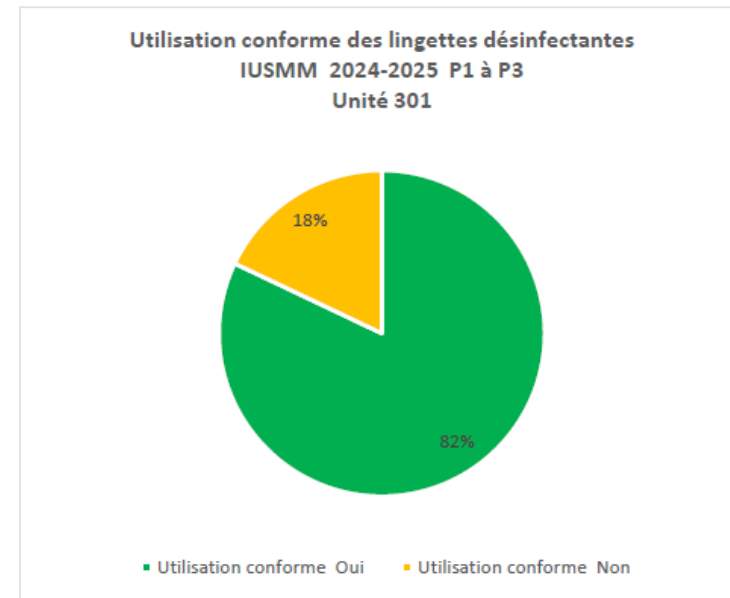


Le nombre total d'observations est de: 39
Le nombre total d'observations conformes est de : 32
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 7

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical




Le nombre total d'observations est de : 24
Le nombre d'observations conformes est de : 19
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 5

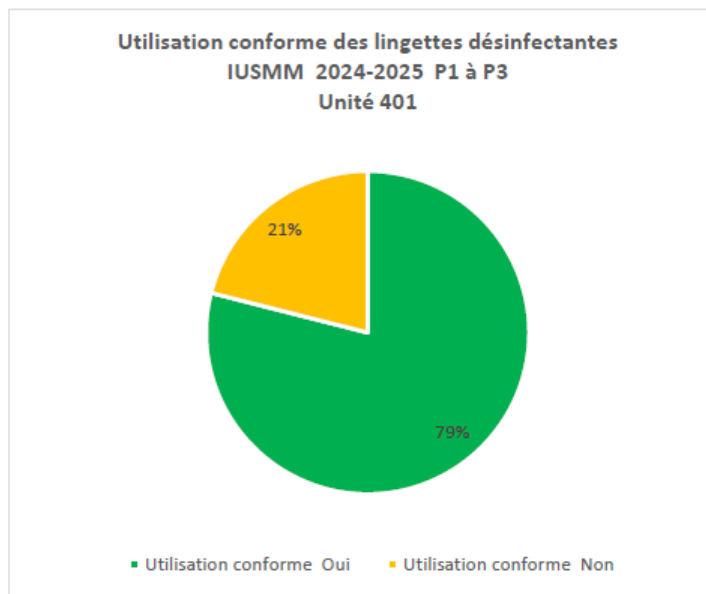


Le nombre total d'observations est de : 19
Le nombre total d'observations conformes est de : 15
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 4

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical




Le nombre total d'observations est de : 3
Le nombre d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 3

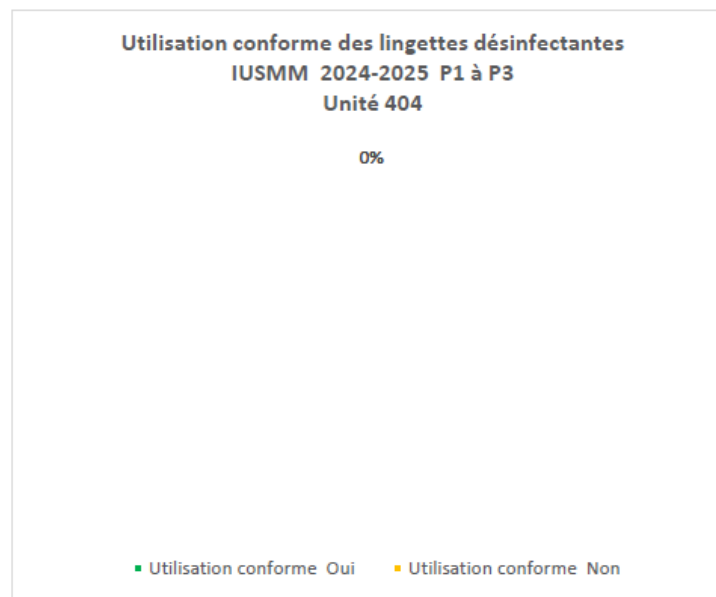


Le nombre total d'observations est de : 0
Le nombre total d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical

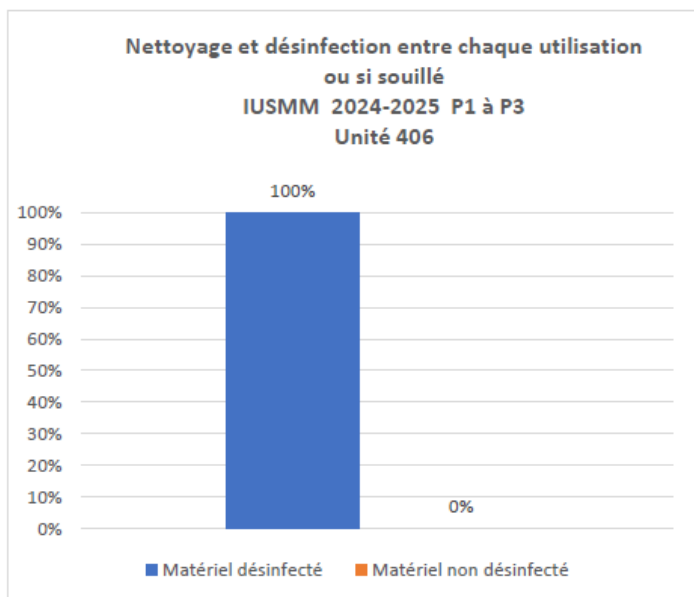


Le nombre total d'observations est de : 1
Le nombre d'observations conformes est de : 1
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0




Le nombre total d'observations est de : 1
Le nombre total d'observations conformes est de : 1
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical




Le nombre total d'observations est de : 2
Le nombre d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 2




Le nombre total d'observations est de : 0
Le nombre total d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0

Audits sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical

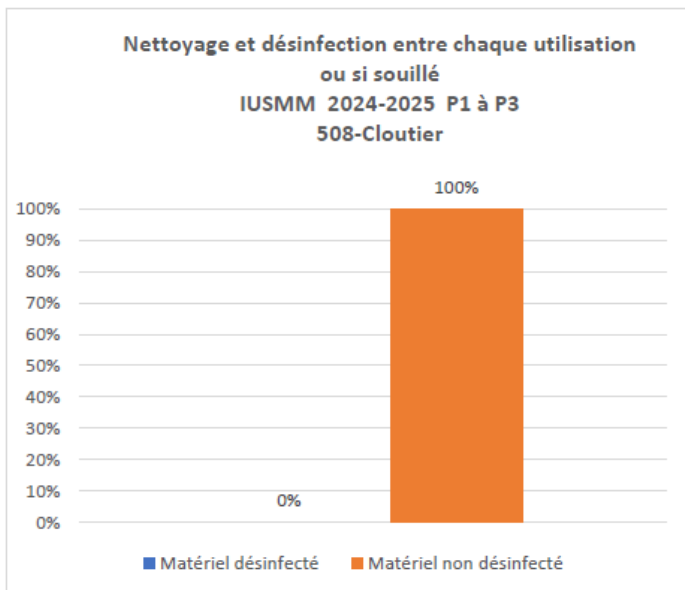

Le nombre total d'observations est de : 3
Le nombre d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 3



Le nombre total d'observations est de : 0
Le nombre total d'observations conformes est de : 0
Le nombre total d'observations non-conformes est de : 0